

Resultados do teste Posi3 USB

Teste SCBA Completo

27/02/2021 15:52:14





EPR 123
BD 0011
S/N: C-54718

EXEMPLO S.A.
ROD. EXEMPLO S/N, KM 317 BAIRRO ABC
SÃO PAULO SP 17121000 (11) 33558899

EXEMPLO S.A.
SÃO PAULO SP

No. de série Posi3 USB L05823 - A calibração estava atualizada quando o teste foi executado

IDs auxiliares		Testes funcionais			
Máscara	OK	Pressão de exalação	5,0	mbar	
Segundo estágio	2068887	Vazamento de máscara	Aprovado	0,4	mbar
Primeiro estágio/redut	C-54718	Pressão da máscara estática	Aprovado	2,9	mbar
Alarme de baixa press	OK	Pressão média estático	7,43	bar	
Conector de cilindro	OK	Troca de Pressão média	0,06	bar	
Conexão de entrada d	OK	Ativação de 1a. respiração	-23,9	mbar	
Estojo com tiras	OK	Vazamento de pressão alta	Aprovado	0,7	bar
Inspeção visual		Fluxo de bypass	122	L/min	
Máscara	Aprovado	Pressão de ativação de alarme			
Estrutura posterior/estojo com ti	Aprovado	300 bar Whistle	Aprovado	58,3	bar
Cilindro	Não executa	Precisão do medidor			
Aviso de baixa pressão	Aprovado	300 bar Numbers	Aprovado		
Tubos	Aprovado	100,0 ±15,0 bar	150,0 ±15,0 bar	200,0 ±15,0 bar	
Volume do coletor: 0,071		Aprovado 102,3	Aprovado 150,0	Aprovado 195,8	

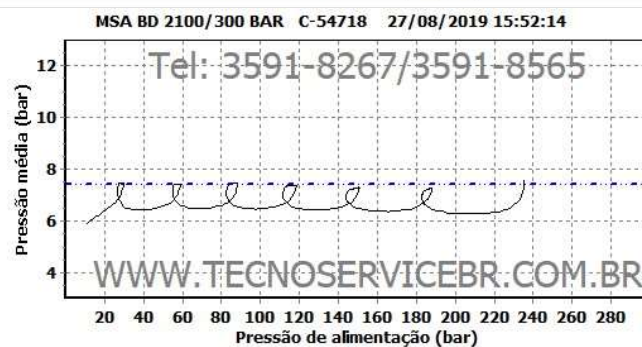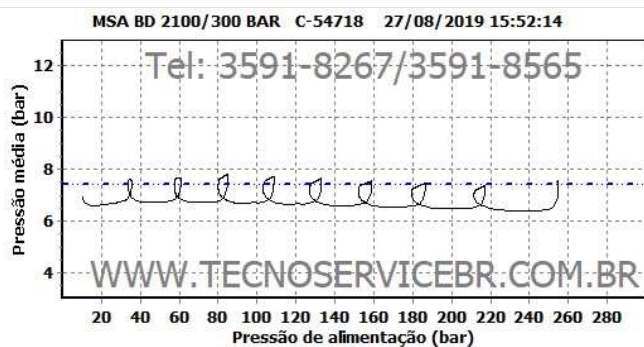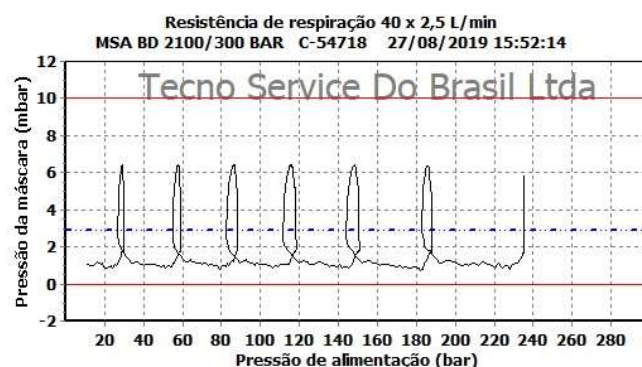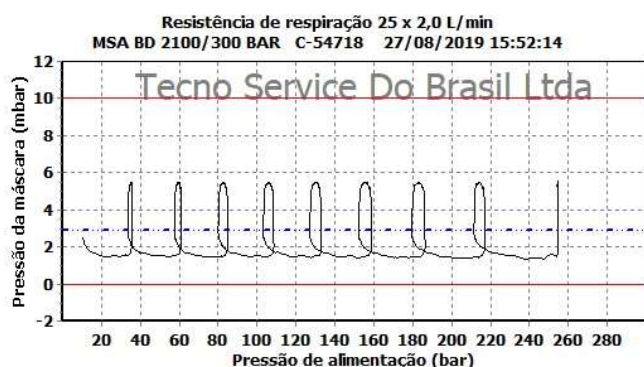

Mínimo	Máximo	Resultados de respi		Mínimo	Máximo
1,3 mbar	5,5 mbar	Aprovado	Pressão da máscara	0,7 mbar	6,4 mbar
6,36 bar	7,80 bar		Pressão média	5,86 bar	7,54 bar

27/08/2019 16:18:35 - Tecno Service: LAUDO DE CALIBRAÇÃO Nº:3051/8292

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O EQUIPAMENTO TESTADO ENCONTRA-SE CALIBRADO E APTO PARA USO.

LAUDO DE CALIBRAÇÃO VALIDO ATÉ: 20/08/2020

Testado por Tecno Service
Tecno Service do Brasil LTDA.
Avenida Analice Sakatauskas, 1040